

Régulateur de vide continu Push-To-Set™ (ISO/CE) Adulte / Pédiatrique / Néonatal Numérique

DESCRIPTION ET APPLICATION

Les régulateurs numériques de vide continu Push-To-Set™ (PTS-CVR) dépassent les attentes cliniques dans le domaine des procédures d'aspiration médicales en offrant le progrès technologique associé à la qualité et à la simplicité dont bénéficient toujours les produits de l'Ohio Medical. Ils disposent de la technologie unique et brevetée Push-To-Set™ qui apporte un moyen de réglage fiable du régulateur pour une aspiration en toute sécurité. Les PTS-CVR assurent une aspiration continue et régulée pour une meilleure gestion des voies respiratoires de la trachée et du pharynx, pour les procédures chirurgicales et le drainage naso-gastrique continu.

Les modèles 2-Mode et 3-Mode Continu Elevé assurent un vide réglable de zéro jusqu'au vide complet disponible de la paroi. L'appareil 3-Mode Elevé possède un mode MAX qui assure un vide complet disponible non régulé et sans restriction de la paroi et est équipé d'un interrupteur pour les aspirations d'urgence. Les deux modèles de vide faible, NEO et PED, comprennent une limite de pression négative afin de limiter la pression négative ou le vide maximal à 13,3 ou 18,0 kPa (100 ou 135 mm Hg) respectivement.

Trois jauges spécialisées sont disponibles. Les appareils Continu Elevé disposent d'une grande jaugé de 5,7 cm qui brille dans le noir, avec une amplitude allant de 0 à 101,3 kPa (0-760 mm Hg), les échelles kPa et mm Hg étant toutes les deux représentées. La jaugé placée sur les unités en continu NEO et PED dispose d'une faible variation correspondant à leur variation de vide limité, un code couleur plus ou moins intense permet la lecture des variations de 0 à 21,3 kPa (0-160 mm Hg), faible = vert, moyenne = jaune et élevée = orange. Cette jaugé sert à la fois pour les variations de vide disponible des modèles NEO (à 13,3 kPa ou 100 mm Hg) et PED (à 18,0 kPa ou 135 mm Hg).

Les PTS-CVR ont une conception ergonomique qui présente deux caractéristiques de sûreté exclusives permettant de simplifier les processus, de réduire les erreurs cliniques et d'augmenter les performances du produit. Le mécanisme breveté Push-To-Set™ permet d'établir automatiquement une limite de vide pour chaque réglage ou modification du niveau de vide. Un module de régulateur unique à double ressort assure précision dans la variation des soins intensifs (0-26,7 kPa/0-200 mm Hg) tout en proposant un ajustement d'une rapidité inhabituelle (2 tours) jusqu'à obtenir un vide disponible complet de la paroi pour les procédures de réanimation d'urgence.

Pour la sécurité du patient et en cas de connexion accidentelle d'un gaz en surpression, ces régulateurs sont équipés d'une soupape de décompression.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **EN EXCLUSIVITÉ !** Système Push-To-Set™ breveté
Améliore la mise en sécurité du patient
Prévient l'aspiration non régulée involontaire
Réduit risques d'infection
Utilisation simple avec une seule main
- **EN EXCLUSIVITÉ !** Quick-To-Max
Une rapidité d'ajustement (2 tours) permettant d'obtenir un vide disponible complet de la paroi pour les procédures de réanimation d'urgence
- **Grande jaugé numérique pour une lecture facile**
Précision inégalée à ± 1 % de l'échelle totale pour plus de sécurité



2-Mode
Elevé



3-Mode
Elevé



2-Mode NEO
0-13.3 kPa
(0-100 mmHg)



2-Mode PED
0-18.0 kPa
(0-135 mmHg)

Variations indiquées par des codes couleur

- **Composants ordinaires modulaires**
Les composants ordinaires permettent de réduire l'inventaire des pièces en service
Simplifient les procédures d'entretien
Kits et pièces de rechange à faible coût
- **Conception et fabrication de qualité durable**
Peu de pièces mécaniques
Boîtier en ABS robuste, résistant aux chocs
Anti-corrosion et sans lubrification
Contre-plaque sans entretien
- **Répond aux normes industrielles depuis 45 ans**
- **Marquage CE**
- **Soupape de sécurité en cas de surpression**
Décharge une surpression afin de protéger le patient et le régulateur en cas de connexion accidentelle à un gaz pressurisé (O₂, air, etc.)
- **Contre-plaque du collecteur scellée**
Meilleure conception pour des joints hermétiques
- **Options disponibles sur commande**
Disponible dans différentes configurations, incluant les adaptateurs pour la connexion à la source de vide et les options pour les dispositifs de collecte et la protection de sécurité anti-débordement.

Mode Trois en Continu Elevé

- Modes : I (ON), O (OFF), MAX
- Jauge : Vide élevé 0-101,3 kPa/0-760 mm Hg
- Bande de couleur : dorée
- Vide régulé : 0 - Vide disponible complet de la paroi
- Mode de vide complet instantané

Mode Deux en Continu Elevé

- Modes : I (ON), O (OFF)
- Jauge : Vide élevé 0-101,3 kPa/0-760 mm Hg
- Bande de couleur : dorée
- Vide régulé : 0 - Vide disponible complet de la paroi

NEO Mode Deux (0-13,3 kPa) en Continu Faible

- Modes : I (ON), O (OFF)
- Jauge : Vide faible 0-21,3 kPa/0-160 mm Hg
- Bande de couleur : faible (verte), moyen (jaune), élevé (orange)
- Vide régulé : 0-13,3 kPa/0-100 mm Hg
- Soupape de sécurité de secours

PED Mode Deux en Continu Faible

- Modes : I (ON), O (OFF)
- Jauge : Vide faible 0-21,3 kPa/0-160 mm Hg
- Bande de couleur : faible (verte), moyen (jaune), élevé (orange)
- Vide régulé : 0-18,0 kPa/0-135 mm Hg
- Soupape de sécurité de secours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit

0-80 L/min sans raccords en pleine progression

Numériques Précision de la jauge

± 1% de l'échelle totale

Dimensions

17,02 x 7,1 x 12,19 cm (6.7" H x 2.8" L x 4.8" P)

Poids

0,57 kg (1,4 livre) (moins les raccords et adaptateurs)

Normes

Conforme aux normes ISO 10079-3 et ASTM F960

*Les spécifications sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de changement sans notification.

INFORMATIONS D'ENVOI

Poids de l'envoi

0,77 kg (1,11 livre) moins les raccords et adaptateurs

Dimensions de l'emballage


6,8" H x 10,5" L x 8" P (17,27 H x 26,67 L x 20,32 P cm)

Conditionnement : Une pièce par carton

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Ohio Medical spécialisé ou un représentant autorisé.



Configuration

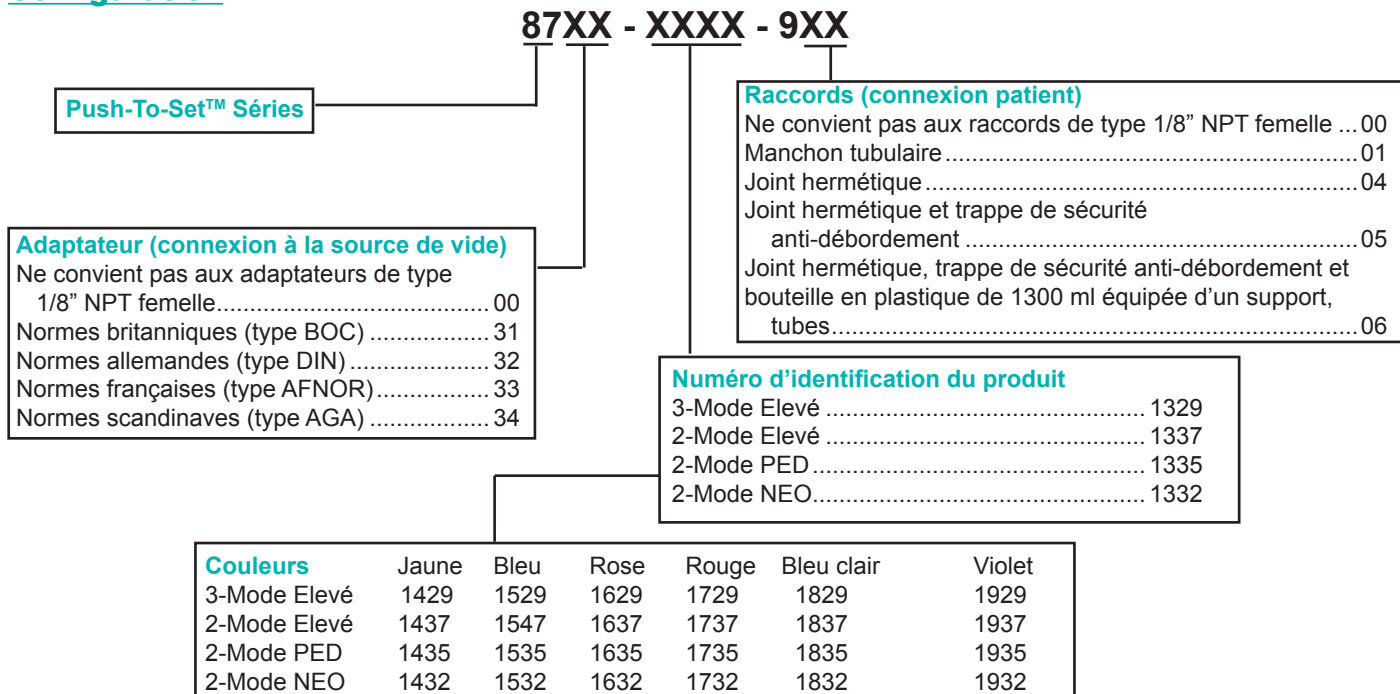

© 2017 Ohio Medical LLC.

Ce document contient des informations confidentielles et sont la propriété de l'Ohio Medical LLC.

L'utilisation de ces informations se fait sous licence de l'Ohio Medical LLC.

Toute utilisation autre que celle autorisée par Ohio Medical LLC est interdite.

Ohio Medical ainsi que le logo Ohio Medical sont des marques déposées d'Ohio Medical LLC.

Push-To-Set est une marque d'Ohio Medical LLC.

Etats-Unis Brevet #6,623,463 (Système de vide Push-To-Set™)



Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031 USA
Phone: +1 847 855 0800 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
550025-FR (Rev. 3, 01/2017)

Représentants autorisés d'Ohio Medical



OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970